



中华人民共和国国家标准

GB/T 12959—2008
代替 GB/T 12959—1991、GB/T 2022—1980

水泥水化热测定方法

Test methods for heat of hydration of cement

2008-01-09 发布

2008-08-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前　　言

本标准参照美国 ASTM C186—1998《水硬性水泥水化热测定方法》、日本 JIS R5203—1987《水泥水化热测定方法 溶解热法》和欧洲 EN 196-8:2003《水化热测定方法 溶解热法》、EN 196-9:2003《定量测定水化热 半绝热法》、俄罗斯 ГОСТ 310.5—1988《水泥水化热量热仪测定法 直接法》等试验方法标准。

本标准代替 GB/T 12959—1991《水泥水化热测定方法(溶解热法)》和 GB/T 2022—1980《水泥水化热试验方法(直接法)》两个标准。

本标准溶解热法与 GB/T 12959—1991 相比,主要变化如下:

- 主要仪器设备热量计由单筒改为双筒;增加了循环水泵、加热装置、量热温度计、广口保温瓶配有耐酸塑料筒(1991 版第 3 章,本版 3.3);
- 灼烧质量由一个样品定值修改为二个样品平均结果定值(1991 版 6.2.2,本版 3.5.2.3);
- 水化样品的存放提出要求(本版 3.5.3.3);
- 规范了试验操作步骤(1991 版第 6 章,本版 3.5)。

本标准直接法与 GB/T 2022—1980 相比,主要变化如下:

- 截锥圆筒材料由原来铜皮改为塑料,内衬由原来牛皮纸改为薄塑料筒(1980 版 1.1.2,本版 4.3);
- 热容量测定散热常数用水量改为 500 g±10 g(1980 版 4.8,本版 4.5.3.3);
- 试验用标准砂改为符合 GB/T 17671 规定的粒度范围在(0.5~1.0)mm 的中砂(1980 版 5.11,本版 4.2.2);
- 试验灰砂比由原来按不同品种、不同等级变化配比改为固定灰砂比,水泥 : 标准砂 = 1 : 3 (1980 版 5.11,本版 4.5.6.4);
- 搅拌方式由手工搅拌改用 ISO 胶砂搅拌机搅拌(1980 版 5.13,本版 4.5.7);
- 原试验胶砂量改为称量 800 g±1 g(1980 版 5.13,本版 4.5.8);
- 增加了仲裁试验样品用水为蒸馏水(本版 4.2.3)。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国水泥标准化技术委员会(SAC/TC 184)归口。

本标准主要起草单位:中国建筑材料科学研究院、中国建筑材料检验认证中心。

本标准参加起草单位:云南省建筑材料产品质量监督检验站、葛洲坝股份有限公司水泥厂、四川金顶集团峨眉山水泥厂、抚顺水泥股份有限公司、浙江金华婺星水泥有限公司。

本标准主要起草人:张秋英、王旭方、霍春明、刘胜、郭俊萍、周桂林、黎锦清、李绍元、张顺、邵水凭。

本标准所代替标准的历次版本情况为:

- GB/T 12959—1991;
- GB/T 2022—1980。

水泥水化热测定方法

1 范围

本标准规定了水泥水化热测定方法的原理、仪器设备、试验室条件、材料、试验操作、结果的计算及处理等。

本标准适用于中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥。其他品种水泥采用溶解热方法时应确定该品种水泥测读温度的时间。

在本标准中溶解热法列为基准法，直接法列为代用法，水泥水化热测定结果有争议时以基准法为准。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1346—2001 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法(eqv ISO 9597:1989)

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法(GB/T 6682—1992, neq ISO 3696:1987)

GB/T 17671 水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)(GB/T 17671—1999, idt ISO 679:1989)

JC/T 681 行星式水泥胶砂搅拌机

3 溶解热法(基准法)

3.1 方法原理

本方法是依据热化学盖斯定律，化学反应的热效应只与体系的初态和终态有关而与反应的途径无关提出的。它是在热量计周围温度一定的条件下，用未水化的水泥与水化一定龄期的水泥分别在一定浓度的标准酸溶液中溶解，测得溶解热之差，作为该水泥在该龄期内所放出的水化热。

3.2 材料、试剂及配制

3.2.1 水泥试样应通过 0.9 mm 的方孔筛，并充分混合均匀。

3.2.2 氧化锌(ZnO)

用于标定热量计热容量，使用前应预先进行如下处理，将氧化锌放入坩埚内，在(900~950)℃下灼烧 1 h 取出，置于干燥器中冷却后，用玛瑙研钵研磨至全部通过 0.15 mm 方孔筛，贮存备用。在进行热容量标定前，应将上述制取的氧化锌约 50 g 在(900~950)℃下灼烧 5 min，然后在干燥器中冷却至室温。

3.2.3 氢氟酸(HF)

浓度为 40% (质量分数) 或密度(1.15~1.18)g/cm³。

3.2.4 硝酸(HNO₃)

一次应配制大量浓度为(2.00±0.02)mol/L 的硝酸溶液。配制时量取浓度为 65%~68% (质量分数) 或密度为 1.39 g/cm³~1.41 g/cm³(20℃) 的浓硝酸 138 mL，加蒸馏水稀释至 1 L。

硝酸溶液的标定：用移液管吸取 25 mL 上述已配制好的硝酸溶液，移入 250 mL 的容量瓶中，用蒸馏水稀释至标线，摇匀。接着用已知浓度(约 0.2 mol/L)的氢氧化钠标准溶液标定容量瓶中硝酸溶液的浓度，该浓度乘以 10 即为上述已配制好的硝酸溶液的浓度。

3.2.5 标准中所用试剂应用分析纯。用于标定的试剂应为基准试剂。所用水应符合 GB/T 6682 中规定的三级水要求。

3.3 仪器设备

3.3.1 溶解热测定时

由恒温水槽、内筒、广口保温瓶、贝克曼差示温度计或量热温度计、搅拌装置等主要部件组成。另配一个曲颈玻璃加料漏斗和一个直颈加酸漏斗。有单筒和双筒两种，双筒如图 1 所示。

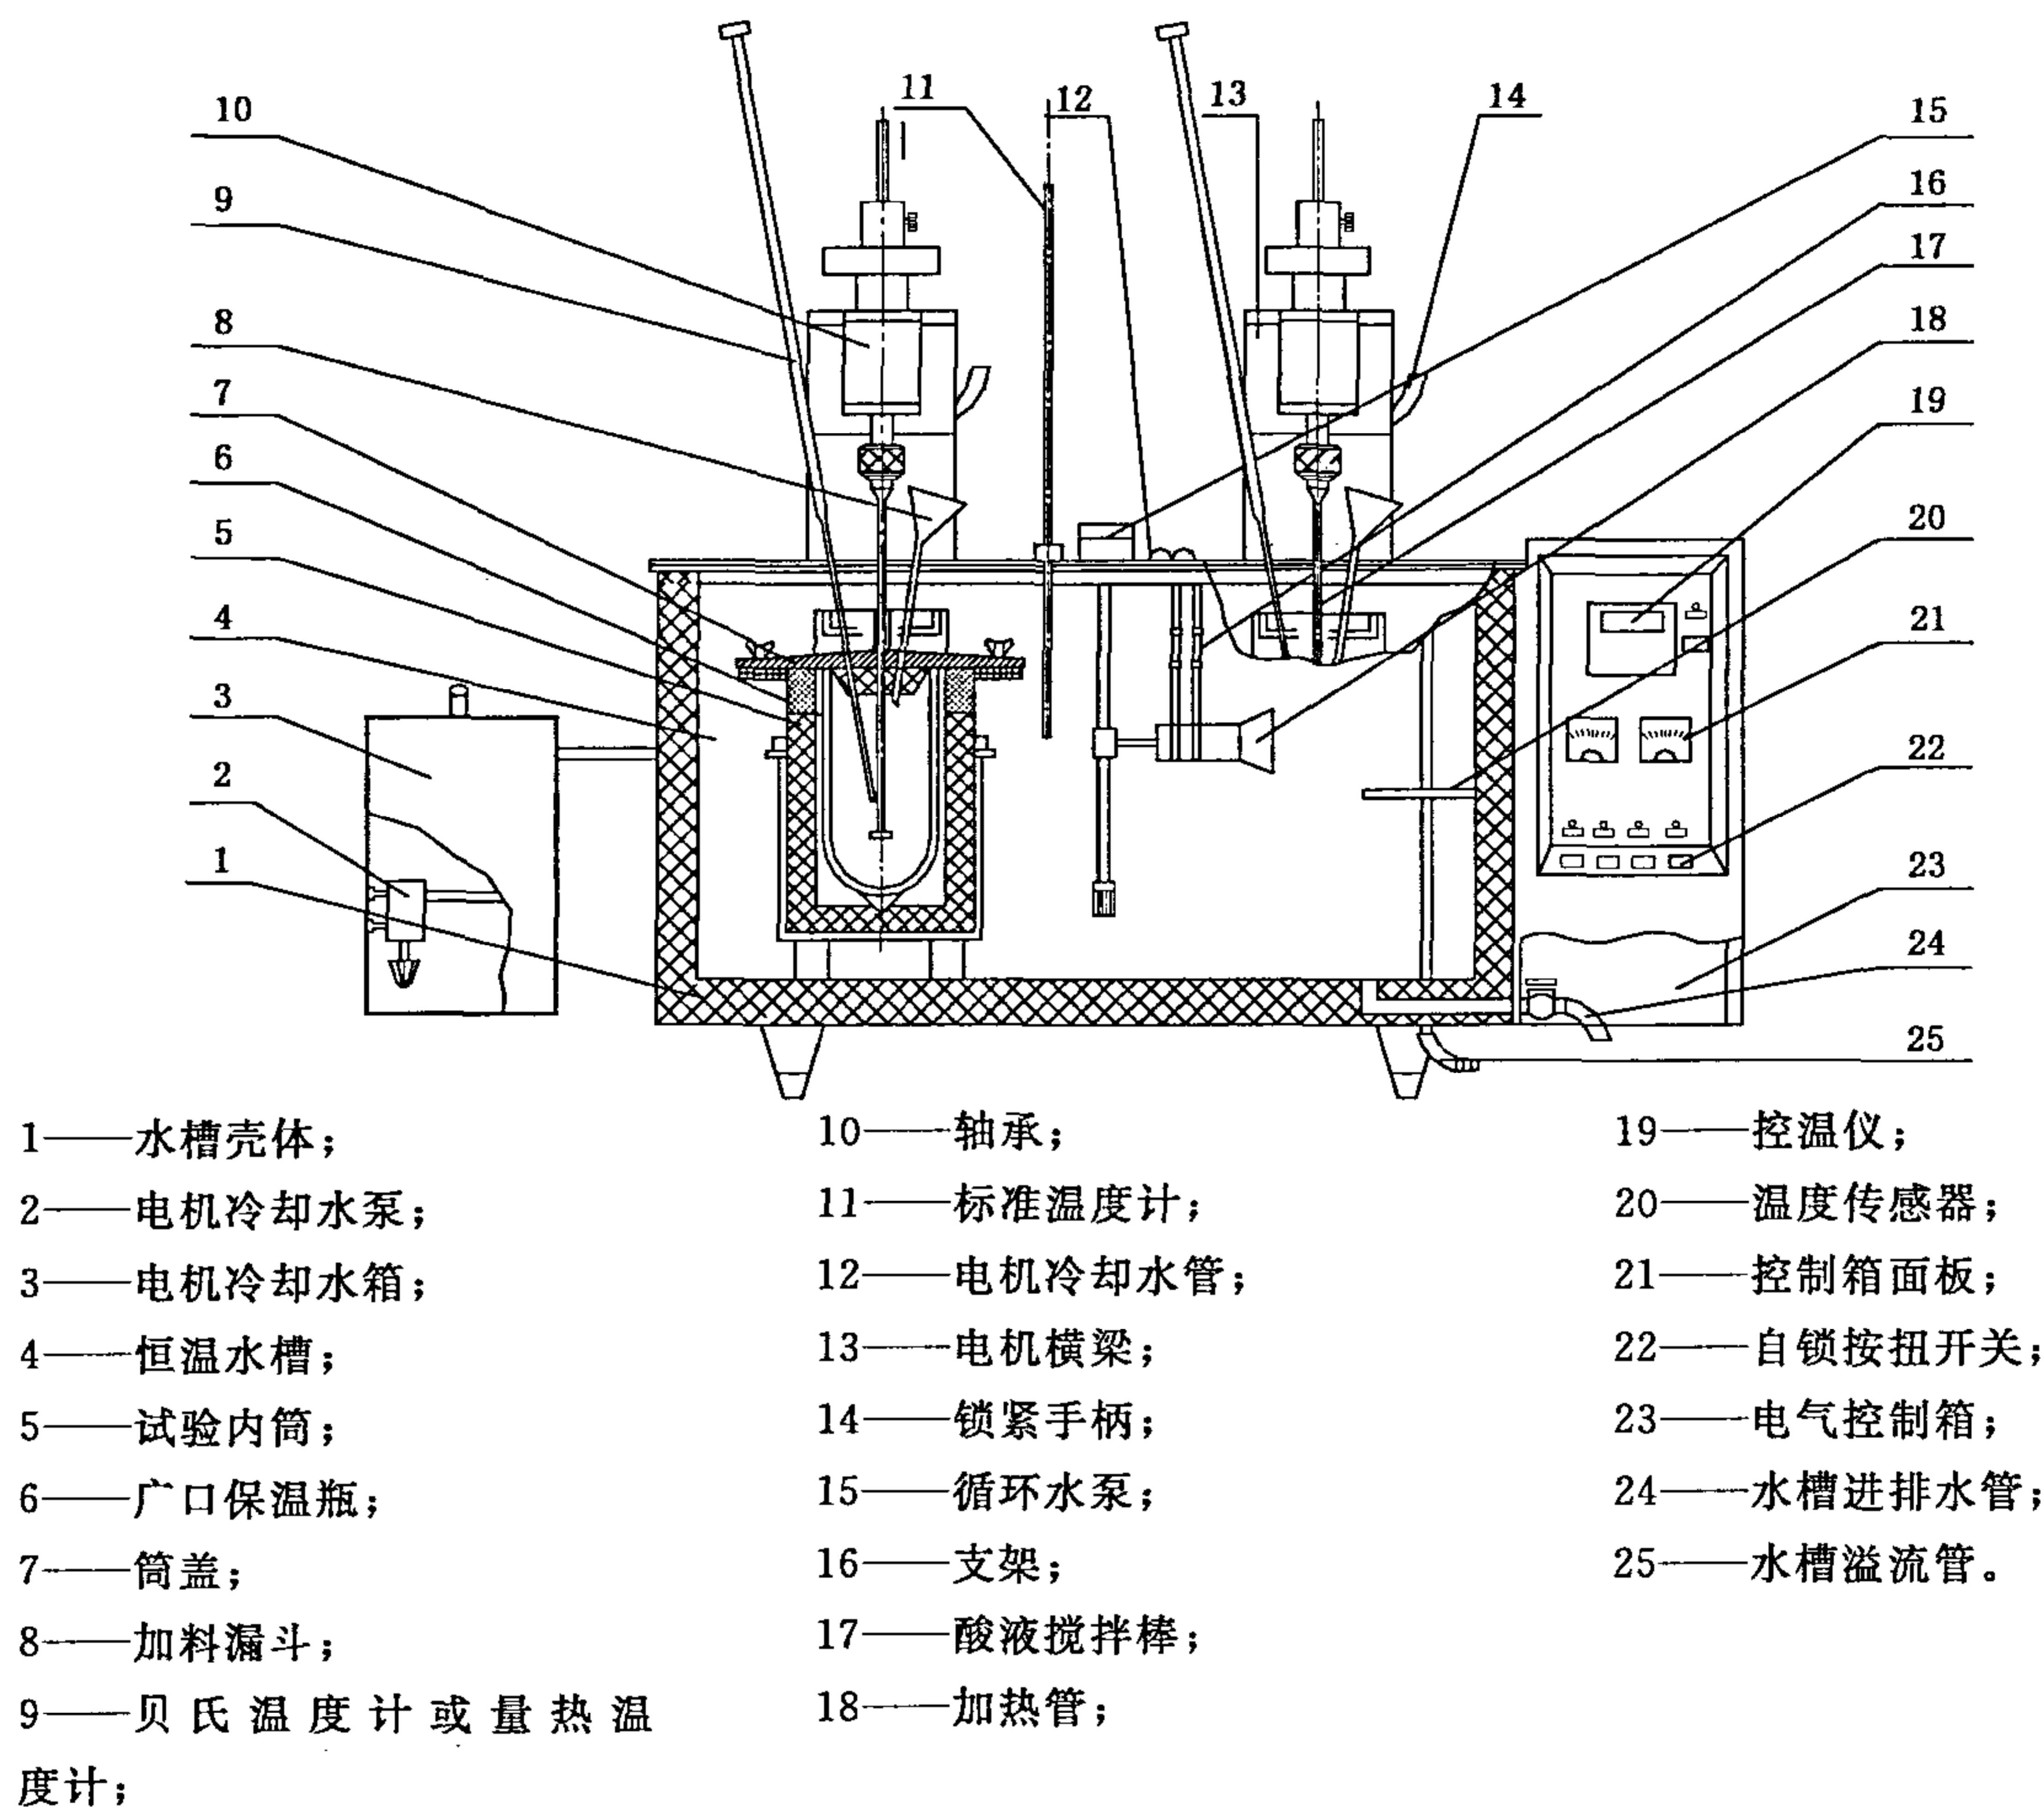


图 1 溶解热测定时

3.3.1.1 恒温水槽

水槽内外壳之间装有隔热层，内壳横断面为椭圆形的金属筒，横断面长轴 750 mm，短轴 450 mm，深 310 mm，容积约 75 L。并装有控制水位的溢流管。溢流管高度距底部约 270 mm，水槽上装有二个用于搅拌保温瓶中酸液的搅拌器，水槽内装有二个放置试验内筒的筒座，进排水管、加热管与循环水泵等部件。

3.3.1.2 内筒

筒口为带法兰的不锈钢圆筒，内径 150 mm，深 210 mm，筒内衬有软木层或泡沫塑料，筒口上镶嵌有橡胶圈以防漏水，盖上有三个孔，中孔安装酸液搅拌棒，两侧的孔分别安装加料漏斗和贝克曼差示温度计或量热温度计。

3.3.1.3 广口保温瓶

配有耐酸塑料筒，容积约为 600 mL，当盛满比室温高约 5℃的水、静置 30 min 时，其冷却速率不得大于 0.001℃/min。

3.3.1.4 贝克曼差示温度计(以下简称贝氏温度计)

分度值为 0.01°C ,最大差示温度为 5.2°C ,插入酸液部分须涂以石蜡或其他耐氢氟酸的材料。试验前应用量热温度计将贝氏温度计零点调整到约 14.500°C 。

3.3.1.5 量热温度计

分度值为 0.01°C ,量程($14\sim20$) $^{\circ}\text{C}$,插入酸液部分须涂以石蜡或其他耐氢氟酸的材料。

3.3.1.6 搅拌装置

酸液搅拌棒直径 $\phi(6.0\sim6.5)\text{ mm}$,总长约 280 mm ,下端装有两片略带轴向推进作用的叶片,插入酸液部分必须用耐氢氟酸的材料制成。水槽搅拌装置使用循环水泵。

3.3.1.7 曲颈玻璃加料漏斗

漏斗口与漏斗管的中轴线夹角约为 30° ,口径约为 70 mm ,深 100 mm ,漏斗管外径 7.5 mm ,长 95 mm ,供装试样用。加料漏斗配有胶塞。

3.3.1.8 直颈加酸漏斗

由耐酸塑料制成,上口直径约 70 mm ,管长 120 mm ,外径 7.5 mm 。

3.3.2 天平

量程不小于 200 g ,分度值为 0.001 g 和量程不小于 600 g ,分度值为 0.1 g 天平各一台。

3.3.3 高温炉

使用温度($900\sim950$) $^{\circ}\text{C}$,并带有恒温控制装置。

3.3.4 试验筛

0.15 mm 和 0.60 mm 方孔筛各一个。

3.3.5 铂金坩埚或瓷坩埚

容量约 30 mL 。瓷坩埚使用前应编号灼烧至恒重。

3.3.6 研钵

钢或铜材料研钵、玛瑙研钵各1个。

3.3.7 低温箱

用于降低硝酸溶液温度。

3.3.8 水泥水化试样瓶

由不与水泥作用的材料制成,具有水密性,容积约 15 mL 。

3.3.9 其他

磨口称量瓶、分度值为 0.1°C 的温度计、放大镜、时钟、秒表、干燥器、容量瓶、吸液管、石蜡、量杯、量筒等。

3.4 试验室条件

3.4.1 试验室温度应保持在(20 ± 1) $^{\circ}\text{C}$,相对湿度不低于 50% 。室内应备有通风设备。

3.4.2 试验期间恒温水槽内的水温应保持在(20 ± 0.1) $^{\circ}\text{C}$ 。

3.4.3 恒温水槽用水为纯净的饮用水。

3.5 试验步骤

3.5.1 热量计热容量的标定

3.5.1.1 贝氏温度计或量热温度计、保温瓶及塑料内衬、搅拌棒等应编号配套使用。使用贝氏温度计试验前应用量热温度计检查贝氏温度计零点。如果使用量热温度计,不需调整零点,可直接测定。

3.5.1.2 在标定热量计热容量的前 24 h 应将保温瓶放入内筒中,酸液搅拌棒放入保温瓶内,盖紧内筒盖,再将内筒放入恒温水槽内。调整酸液搅拌棒悬臂梁使夹头对准内筒中心孔,并将酸液搅拌棒夹紧。在恒温水槽内加水使水面高出试验内筒盖(由溢流管控制高度),打开循环水泵等,使恒温水槽内的水温调整并保持到(20 ± 0.1) $^{\circ}\text{C}$,然后关闭循环水泵备用。

3.5.1.3 试验前打开循环水泵,观察恒温水槽温度使其保持在(20 ± 0.1) $^{\circ}\text{C}$,从安放贝氏温度计孔插入

直颈加酸漏斗，用 500 mL 耐酸的塑料杯称取(13.5±0.5)℃的(2.00±0.02)mol/L 硝酸溶液约 410 g，量取 8 mL 40% 氢氟酸加入耐酸塑料量杯内，再加入少量剩余的硝酸溶液，使两种混合溶液总质量达到(425±0.1)g，用直颈加酸漏斗加入到保温瓶内，然后取出加酸漏斗，插入贝氏温度计或量热温度计，中途不应拔出避免温度散失。

3.5.1.4 开启保温瓶中的酸液搅拌棒,连续搅拌 20 min 后,在贝氏温度计或量热温度计上读出酸液温度,此后每隔 5 min 读一次酸液温度,直至连续 15 min,每 5 min 上升的温度差值相等时(或三次温度差值在 0.002°C 内)为止。记录最后一次酸液温度,此温度值即为初测读数 θ_0 ,初测期结束。

3.5.1.5 初测期结束后,立即将事先称量好的(7±0.001)g 氧化锌通过加料漏斗徐徐地加入保温瓶酸液中(酸液搅拌棒继续搅拌),加料过程须在 2 min 内完成,漏斗和毛刷上均不得残留试样,加料完毕盖上胶塞,避免试验中温度散失。

3.5.1.6 从读出初测读数 θ_0 起分别测读 20 min、40 min、60 min、80 min、90 min、120 min 时贝氏温度计或量热温度计的读数，这一过程为溶解期。

3.5.1.7 热量计在各时间内的热容量按式(1)计算,计算结果保留至 0.1 J/°C.

武中。

C——热量计热容量,单位为焦耳每摄氏度(J/°C);

G_0 ——氯化镁重量, 单位为克(g);

t——氯化锌加入热量计时的室温，单位为摄氏度(℃)；

t_a ——溶解期第一次测读数 θ_a 加贝氏温度计 0°C 时相应的摄氏温度(如使用量热温度计时, t_a 的数值等于 θ_a 的读数)单位为摄氏度($^{\circ}\text{C}$);

R_0 ——经校正的温度上升值,单位为摄氏度(°C);

1 072.0——氯化锌在 30°C时溶解热,单位为焦耳每克(J/g);

0.4——溶解热负温比热容,单位为焦耳每克摄氏度[J/(g·°C)];

0.5——氧化锌比热容,单位为焦耳每克摄氏度[J/(g·°C)]。

R_0 值按式(2)计算, 计算结果保留至 0.001°C :

$$P = (0, A)$$

$$b-a$$

6

θ ——溶解期第一次测速的贝氏温度计或量热温度计的读数，单位为摄氏度(°C)。

a — 溶解期结束时测速的贝氏温度计或量热温度计的读数，单位为摄氏度(°C)。

分别与测速 α 或 β 时距商测初速数 α 时所经过的时间。单位为分(min)。

为了保证试验结果的精度，热导池热容量应为 0.2 ml 的测速时间 t 应大于

3.3.1.6 为了保证试验结果的精度, 烧重环和各重对应 t_a 、 t_b 的测读时间 a 、 b 应分别与不同品种水泥所需要的溶解期测读时间对应, 不同品种水泥的具体溶解期测读时间按表 1 规定。

表一 各品种水泥测读温度的时间

单位为分

水泥品种	距初测期温度 θ_0 的相隔时间	
	a	b
硅酸盐水泥		
中热硅酸盐水泥		
低热硅酸盐水泥	20	40
普通硅酸盐水泥		

表 1 (续)

单位为分

水泥品种	距初测期温度 θ_0 的相隔时间	
	<i>a</i>	<i>b</i>
矿渣硅酸盐水泥	40	60
低热矿渣硅酸盐水泥		
火山灰硅酸盐水泥	60	90
粉煤灰硅酸盐水泥	80	120

3.5.1.9 热量计热容量应平行标定两次,以两次标定值的平均值作为标定结果。如果两次标定值相差大于 $5.0\text{ J}/^{\circ}\text{C}$ 时,应重新标定。

3.5.1.10 在下列情况下，热容量应重新标定：

- a) 重新调整贝氏温度计时；
 - b) 当温度计、保温瓶、搅拌棒更换或重新涂覆耐酸涂料时；
 - c) 当新配制的酸液与标定热量计热容量的酸液浓度变化大于±0.02 mol/L 时；
 - d) 对试验结果有疑问时。

3.5.2 未水化水泥溶解热的测定

3.5.2.1 按 3.5.1.1~3.5.1.4 进行准备工作和初测期试验，并记录初测温度 θ_0' 。

3.5.2.2 读出初测温度 θ_0' 后，立即将预先称好的四份(3±0.001)g 未水化水泥试样中的一份在 2 min 内通过加料漏斗徐徐加入酸液中，漏斗、称量瓶及毛刷上均不得残留试样，加料完毕盖上胶塞。然后按表 1 规定的各品种水泥测读温度的时间，准时读记贝氏温度计读数 θ_a' 和 θ_b' 。第二份试样重复第一份的操作。

3.5.2.3 余下二份试样置于(900~950)℃下灼烧 90 min, 灼烧后立即将盛有试样的坩埚置于干燥器内冷却至室温, 并快速称量。灼烧质量 G_1 以二份试样灼烧后的质量平均值确定, 如二份试样的灼烧质量相差大于 0.003 g 时, 应重新补做。

3.5.2.4 未水化水泥的溶解热按式(3)计算,计算结果保留至0.1J/g;

式中：

g_1 ——未水化水泥试样的溶解热,单位为焦耳每克(J/g);

C——对应测读时间的热量计热容量,单位为焦耳每摄氏度(J/°C);

G_1 ——未水化水泥试样灼烧后的质量,单位为克(g);

T' ——未水化水泥试样装入热量计时的室温,单位为摄氏度(°C);

t_a' ——未水化水泥试样溶解期第一次测读数 θ_a' 加贝氏温度计 0℃时相应的摄氏温度(如使用量热温度计时, t_a' 的数值等于 θ_a' 的读数), 单位为摄氏度(°C);

R_1 ——经校正的温度上升值,单位为摄氏度($^{\circ}\text{C}$);

0.8——未水化水泥试样的比热容,单位为焦耳每克摄氏度[J/(g·°C)]。

R_1 值按式(4)计算,计算结果保留至 0.001°C :

式中：

θ_0' 、 θ_a' 、 θ_b' ——分别为未水化水泥试样初测期结束时的贝氏温度计读数、溶解期第一次和第二次测读时的贝氏温度计读数,单位为摄氏度(℃);

a' 、 b' ——分别为未水化水泥试样溶解期第一次测读时 θ_a' 与第二次测读时 θ_b' 距初读数 θ_0' 的时间, 单位为分(min)。

3.5.2.5 未水化水泥试样的溶解热以两次测定值的平均值作为测定结果, 如两次测定值相差大于 10.0 J/g 时, 应进行第三次试验, 其结果与前试验中一次结果相差小于 10.0 J/g 时, 取其平均值作为测定结果, 否则应重做试验。

3.5.3 部分水化水泥溶解热的测定

3.5.3.1 在测定未水化水泥试样溶解热的同时, 制备部分水化水泥试样。测定两个龄期水化热时, 称 100 g 水泥加 40 mL 蒸馏水, 充分搅拌 3 min 后, 取近似相等的浆体二份或多份, 分别装入符合 3.3.8 要求的试样瓶中, 置于(20±1)℃的水中养护至规定龄期。

3.5.3.2 按 3.5.1.1~3.5.1.4 进行准备工作和初测期试验, 并记录初测温度 θ_0'' 。

3.5.3.3 从养护水中取出一份达到试验龄期的试样瓶, 取出水化水泥试样, 迅速用金属研钵将水泥试样捣碎并用玛瑙研钵研磨至全部通过 0.60 mm 方孔筛, 混合均匀放入磨口称量瓶中, 并称出 4.200 g±0.050 g(精确至 0.001 g)试样四份, 然后存放在湿度大于 50% 的密闭容器中, 称好的样品应在 20 min 内进行试验。两份供作溶解热测定, 另两份进行灼烧。从开始捣碎至放入称量瓶中的全部时间应不大于 10 min。

3.5.3.4 读出初测期结束时的温度 θ_0'' 后, 立即将称量好的一份试样在 2 min 内通过加料漏斗徐徐加入酸液中, 漏斗、称量瓶及毛刷上均不得残留试样, 加料完毕盖上胶塞, 然后按表 1 规定不同水泥品种的测读时间, 准时读记贝氏温度计或量热温度计读数 θ_a'' 和 θ_b'' 。第二份试样重复第一份的操作。

3.5.3.5 余下二份试样进行灼烧, 灼烧质量 G_2 按 3.5.2.3 进行。

3.5.3.6 经水化某一龄期后水泥的溶解热按式(5)计算, 计算结果保留至 0.1 J/g:

$$q_2 = \frac{R_2 \cdot C}{G_2} - 1.7(T'' - t_a'') + 1.3(t_a'' - t_a') \quad (5)$$

式中:

q_2 ——经水化某一龄期后水化水泥试样的溶解热, 单位为焦耳每克(J/g);

C ——对应测读时间的热量计热容量, 单位为焦耳每摄氏度(J/℃);

G_2 ——某一龄期水化水泥试样灼烧后的质量, 单位为克(g);

T'' ——水化水泥试样装入热量计时的室温, 单位为摄氏度(℃);

t_a'' ——水化水泥试样溶解期第一次测读数 θ_a'' 加贝氏温度计 0℃ 时相应的摄氏温度, 单位为摄氏度(℃);

t_a' ——未水化水泥试样溶解期第一次测读数 θ_a' 加贝氏温度计 0℃ 时相应的摄氏温度, 单位为摄氏度(℃);

R_2 ——经校正的温度上升值, 单位为摄氏度(℃);

1.7——水化水泥试样的比热容, 单位为焦耳每克摄氏度[J/(g·℃)];

1.3——温度校正比热容, 单位为焦耳每克摄氏度[J/(g·℃)]。

R_2 值按式(6)计算, 计算结果保留至 0.001℃:

$$R_2 = (\theta_a'' - \theta_0'') - \frac{a''}{b'' - a''}(\theta_b'' - \theta_a'') \quad (6)$$

式中:

θ_0'' 、 θ_a'' 、 θ_b'' 、 a'' 、 b'' 与前述相同, 但在这里是代表水化水泥试样。

3.5.3.7 部分水化水泥试样的溶解热测定结果按 3.5.2.5 的规定进行。

3.5.3.8 每次试验结束后, 将保温瓶中的耐酸塑料筒取出, 倒出筒内废液, 用清水将保温瓶内筒、贝氏温度计或量热温度计、搅拌棒冲洗干净, 并用干净纱布擦干, 供下次试验用。涂蜡部分如有损伤, 松裂或脱落应重新处理。

$$K = (C + W \times 4.1816) \frac{\lg(T_1 - 20) - \lg(T_2 - 20)}{0.434 \Delta t} \quad \dots \dots \dots (9)$$

式中：

K ——散热常数,单位为焦耳每小时摄氏度[J/(h·°C)];

W——加水质量，单位为克(g)；

C——热量计的热容量,单位为焦耳每摄氏度(J/°C);

T_1 ——试验开始后 6 h 读取热量计的温度, 单位为摄氏度(°C);

T_2 ——试验开始后 44 h 读取热量计的温度,单位为摄氏度(°C);

Δt ——读数 T_1 至 T_2 所经过的时间, 38 h。

4.5.5 热量计散热常数的规定

- a) 热量计散热常数应测定两次，两次差值小于 $4.18 \text{ J}/(\text{h} \cdot ^\circ\text{C})$ 时，取其平均值；
 - b) 热量计散热常数 K 小于 $167.00 \text{ J}/(\text{h} \cdot ^\circ\text{C})$ 时允许使用；
 - c) 热量计散热常数每年应重新测定；
 - d) 已经标定好的热量计如更换任意部件应重新测定。

4.5.6 水泥水化热测定操作

4.5.6.1 按 4.5.3.1 进行准备工作。

4.5.6.2 试验前热量计各部件和试验材料预先在(20±2)℃温度下恒温 24 h, 截锥形圆筒内放入塑料衬筒。

4.5.6.3 按照 GB/T 1346—2001 方法测出每个样品的标准稠度用水量，并记录。

4.5.6.4 试验胶砂配比

每个样品称标准砂 1 350 g, 水泥 450 g, 加水量按(10)式计算, 计算结果保留至 1 mL:

式中：

M ——试验用水量,单位为毫升(mL);

P ——标准稠度用水量，%；

5%——加水系数。

4.5.7 首先用潮湿布擦拭搅拌锅和搅拌叶,然后依次把称好的标准砂和水泥加入到搅拌锅中,把锅固定在机座上,开动搅拌机慢速搅拌 30 s 后徐徐加入已量好的水量,并开始计时,慢速搅拌 60 s,整个慢速搅拌时间为 90 s,然后再快速搅拌 60 s,改变搅拌速度时不停车。加水时间在 20 s 内完成。

4.5.8 搅拌完毕后迅速取下搅拌锅并用勺子搅拌几次,然后用天平称取 2 份质量为(800±1)g 的胶砂,分别装入已准备好的 2 个截锥形圆筒内,盖上盖子,在圆筒内胶砂中心部位用捣棒捣一个洞,分别移入到对应保温瓶中,放入套管,盖好带有温度计的软木塞,用胶泥或蜡密封,以防漏水。

4.5.9 从加水时间算起第 7 min 读第一次温度,即初始温度 T_0 。

4.5.10 读完温度后移入到恒温水槽中固定,根据温度变化情况确定读取温度时间,一般在温度上升阶段每隔 1 h 读一次,下降阶段每隔 2 h、4 h、8 h、12 h 读一次。

4.5.11 从开始记录第一次温度时算起到 168 h 时记录最后一次温度, 末温 T_{168} , 试验测定结束。

4.5.12 全部试验过程热量计应整体浸在水中,养护水面至少高于热量计上表面 10 mm,每次记录温度时都要监测恒温水槽水温是否在(20±0.1)℃范围内。

4.5.13 拆开密封胶泥或蜡,取下软木塞,取出截锥形圆筒,打开盖子,取出套管,观察套管中、保温瓶中是否有水,如有水此瓶试验作废。

4.5.14 试验结果的计算

4.5.14.1 曲线面积的计算

根据所记录时间与水泥胶砂的对应温度,以时间为横坐标($1\text{ cm} \Rightarrow 5\text{ h}$),温度为纵坐标($1\text{ cm} \Rightarrow 1^\circ\text{C}$)

在坐标纸上作图，并画出 20℃水槽温度恒温线。恒温线与胶砂温度曲线间的总面积（恒温线以上的面积为正面积，恒温线以下的面积为负面积） $\sum F_{0-x}(h \cdot ^\circ C)$ 可按下列计算方法求得。

- a) 用求积仪求得；
 - b) 把恒温线与胶砂温度曲线间的面积按几何形状划分为若干个小三角形，抛物线，梯形面积 $F_1, F_2, F_3 \dots \dots (h \cdot ^\circ C)$ 等，分别计算，然后将其相加，因为 1 cm^2 相当于 $5 h \cdot ^\circ C$ ，所以总面积乘以 5 即得 $\sum F_{0-x} (h \cdot ^\circ C)$ ；
 - c) 近似矩形法
如图 2 所示，以每 $5 h (1 \text{ cm})$ 作为一个计算单位，并作为矩形的宽度，矩形的长度（温度值）是通过面积补偿确定。在图 2 补偿的面积中间选一点，这一点如能使一个计算单位内阴影面积与曲线外的空白面积相等，那么这一点的高度便可作为矩形的长度，然后与宽度相乘即得矩形的面积。将每一个矩形的面积相加，再乘以 5 即得 $\sum F_{0-x} (h \cdot ^\circ C)$ ；
 - d) 用电子仪器自动记录和计算；
 - e) 其他方法。

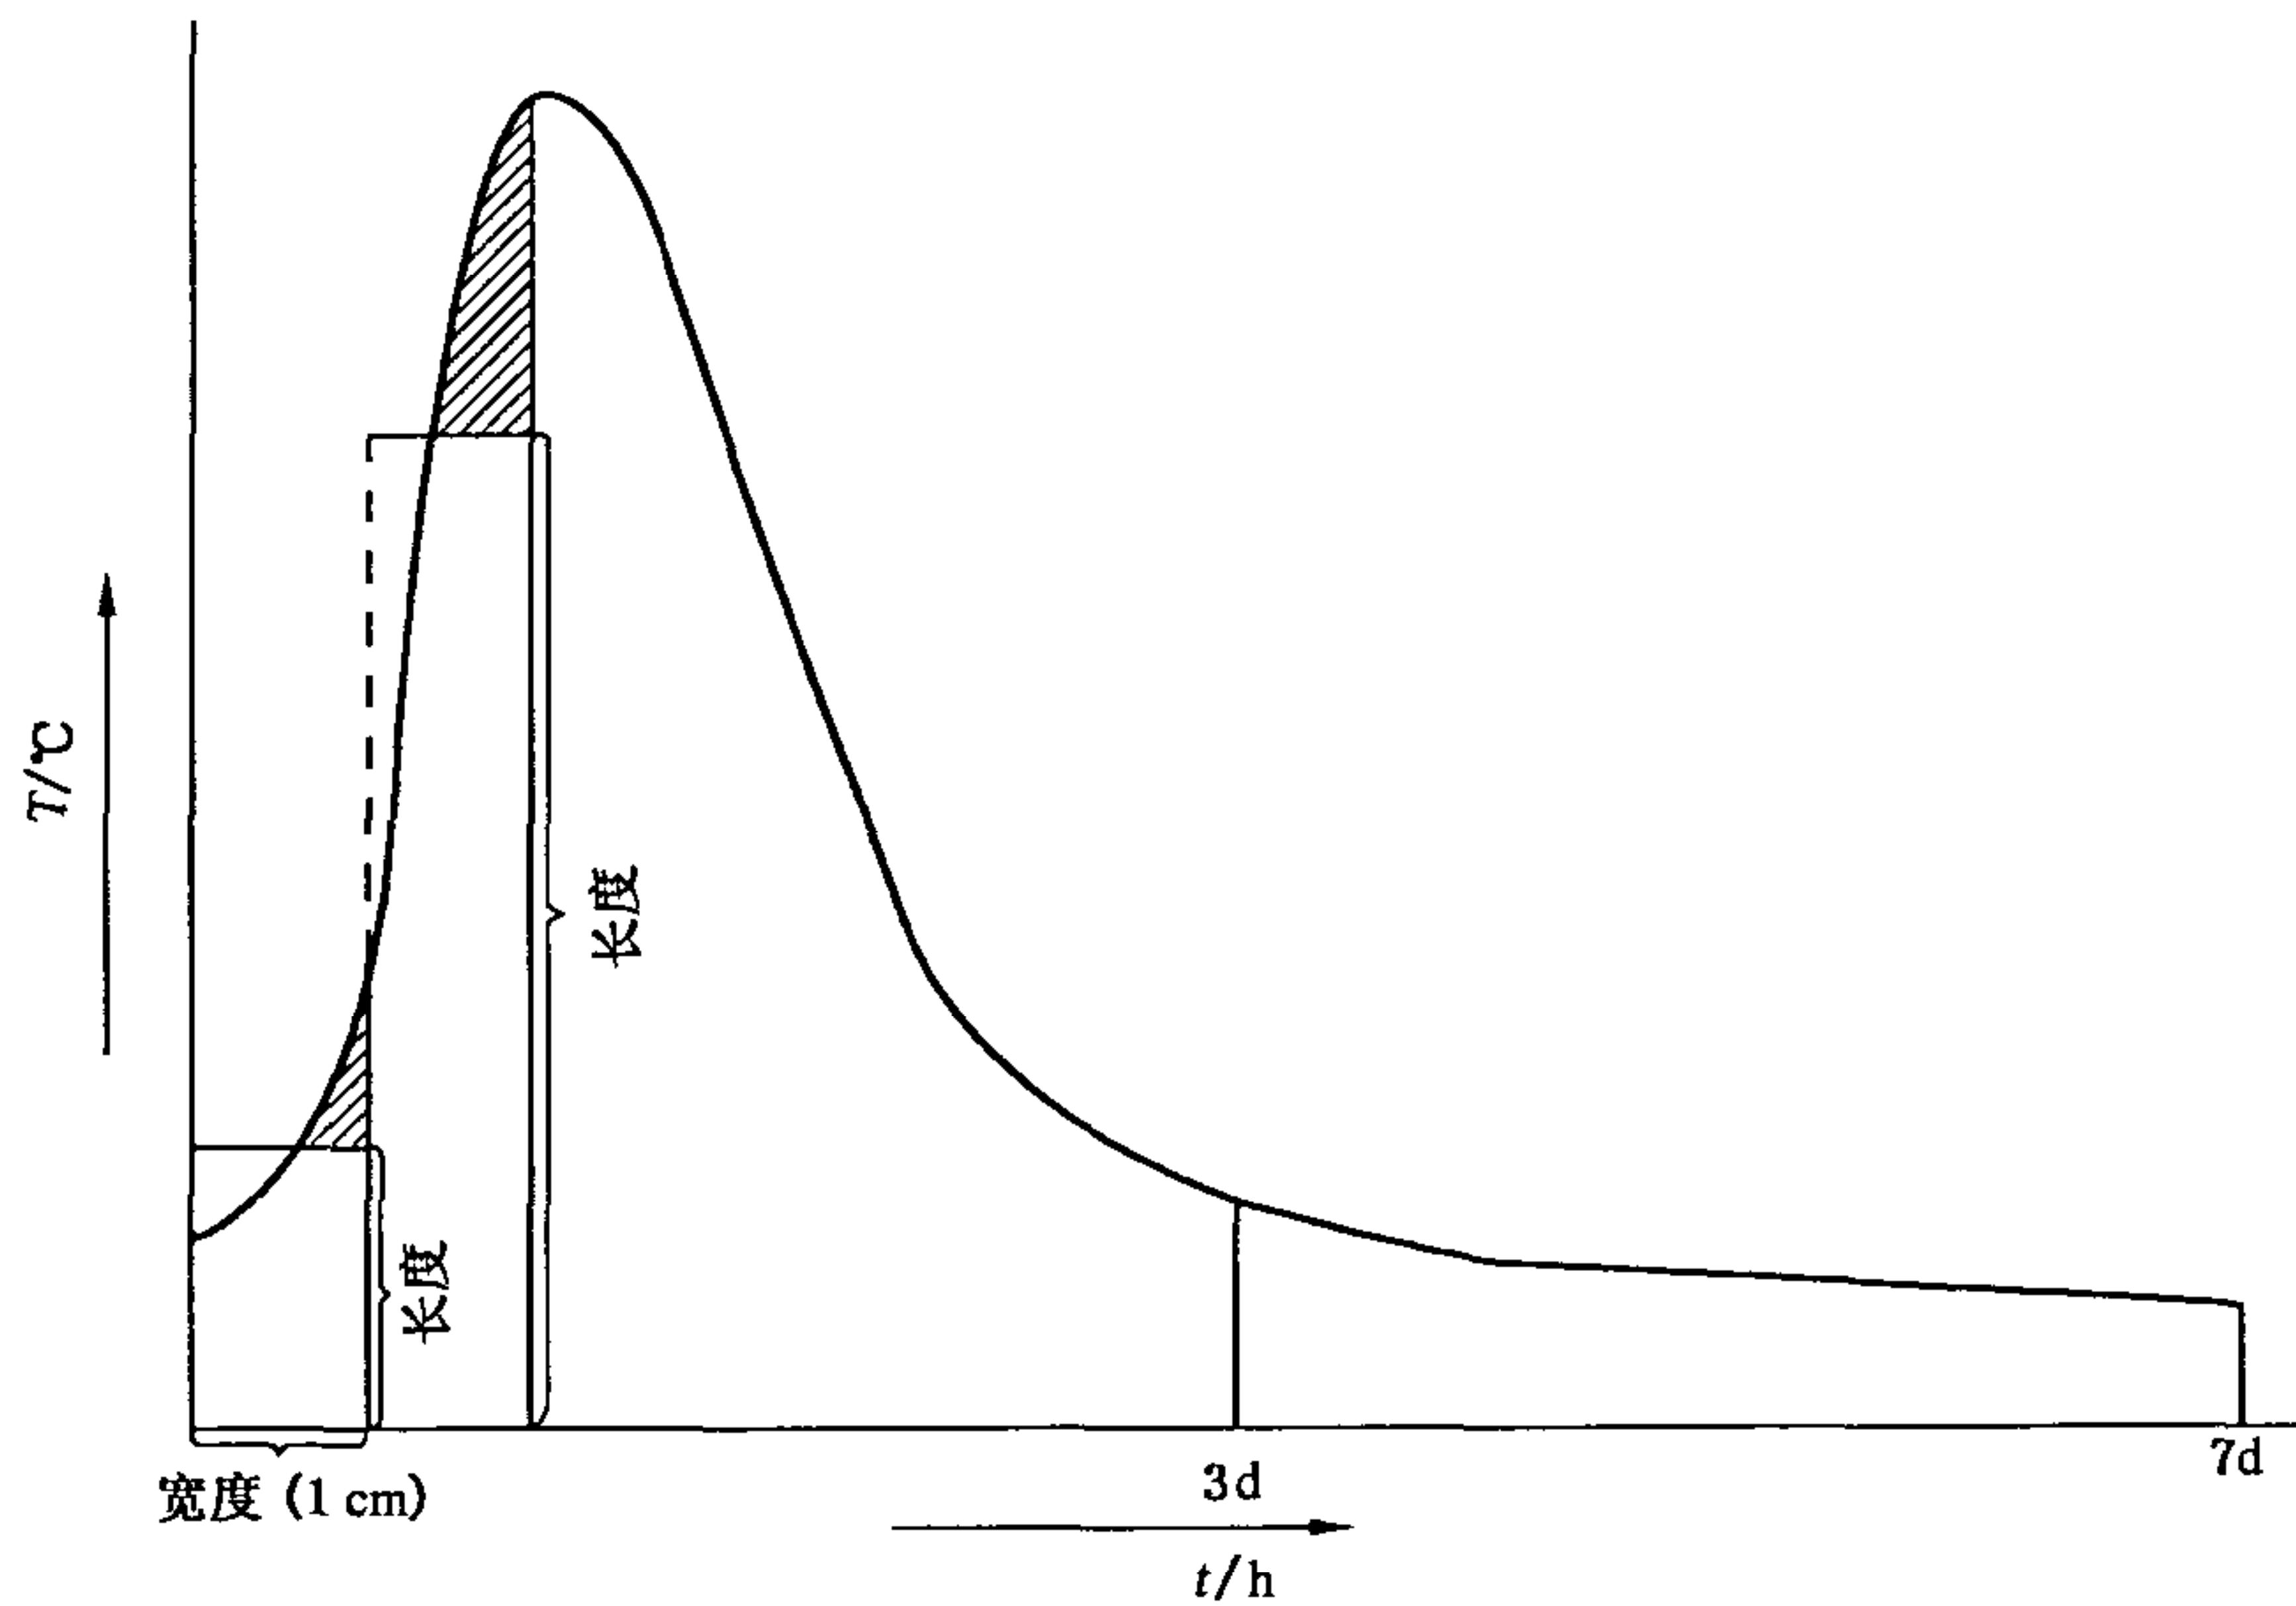


图 2 近似矩形法

4.5.14.2 试验用水泥质量(G)按(11)式计算,计算结果保留至1 g:

式中：

G——试验用水泥质量,单位为克(g);

P——水泥净浆标准稠度，%；

800——试验用水泥胶砂总质量,单位为克(g);

5%——加水系数。

4.5.14.3 试验中用水量(M_1)按(12)式计算,计算结果保留至1mL:

式中：

M_1 ——试验中用水量，单位为毫升(mL)；

P——水泥净浆标准稠度，%。

4.5.14.4 总热容量的计算 C_p

根据水量及热量计的热容量 C , 按(13)式计算, 计算结果保留至 $0.1 \text{ J}/\text{ }^\circ\text{C}$:

式中：

C_p ——装入水泥胶砂后的热量计的总热容量,单位为焦耳每摄氏度($J/^\circ C$);

M_1 ——试验中用水量，单位为毫升(mL)；

C——热量计的热容量,单位为焦耳每摄氏度(J/°C)。

4.5.14.5 总热量的计算 Q_x

在某个水化龄期时,水泥水化放出的总热量为热量计中蓄积和散失到环境中热量的总和 Q_x 按(14)式计算,计算结果保留至 0.1 J:

式中：

Q_x ——某个龄期时水泥水化放出的总热量，单位为焦耳(J)；

C_p ——装水泥胶砂后热量计的总热容量；单位为焦耳每摄氏度($J/^\circ C$)；

t_x ——龄期为 X 小时的水泥胶砂温度, 单位为摄氏度(°C);

t_0 ——水泥胶砂的初始温度，单位为摄氏度(°C)；

K ——热量计的散热常数，单位为焦耳每小时摄氏度 [$J/(h \cdot {}^\circ C)$]；

$\sum F_{0 \sim x}$ ——在 0~X 小时水槽温度恒温线与胶砂温度曲线间的面积，单位为小时摄氏度(h·°C)。

4.5.14.6 水泥水化热的计算 q_x

在水化龄期 X 小时水泥的水化热 q_x , 按(15)式计算, 计算结果保留至 1 J/g:

式中：

q_x ——水泥某一龄期的水化热,单位为焦耳每克(J/g);

Q_x ——水泥某一龄期放出的总热量，单位为焦耳(J)；

G——试验用水泥质量,单位为克(g)。

4.5.15 每个水泥样品水化热试验用两套热量计平行试验,两次试验结果相差小于 12 J/g 时,取平均值为此水泥样品的水化热结果;两次试验结果相差大于 12 J/g 时,应重做试验。

中华人民共和国

国家标准

水泥水化热测定方法

GB/T 12959—2008

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

网址 www.spc.net.cn

电话：68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 25 千字
2008 年 4 月第一版 2008 年 4 月第一次印刷

*

书号：155066 · 1-31018

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话：(010)68533533



GB/T 12959-2008